

# CALEX社放射温度計用ソフトウェア(無償)

## CalexConfigソフトウェア、放射温度計用、無償簡単ソフトウェア



- 測定温度の読み取り表示
- 放射温度計のコンフィギュレーション (設定)
- データのスクローリング、温度グラフ表示
- コマ区切りのテキストファイル(csv)でのデータロギング(Excel変換対応)

適合形式(USBバージョン)  
適合形式(RS485 modbusバージョン)  
システム要件

PyroMiniUSB, PyroUSB, ExTempMini, ExTemp PyroMiniBus, PyroMini (-BB and -BRT)  
デスクトップPCまたはパネル PC  
Windows 7 または以降 (32 or 64 bit), 最低800x600 スクリーン解像度, タッチスクリーン, またはマウスとキーボード


(記) CalexConfigソフトウェアの最新バージョンはホームページで確認く

\* ExTemp/EXTempMini 本安防爆形放射温度計での使用時、ソフトウェアはセンサのコンフィギュレーション (設定) です。連続温度測定には4-20mA出力を使用ください。

### PyroMini の場合のCalexConfigソフトウェア画面

#### 主な設定パラメータ

- 4-20mA出力提供の放射温度計の場合、4-20mAの温度スケール機能
- 放射率 (emissivity) 設定
- 反射エネルギー補正
- 温度フィルターリング
- データロギング、サンプリング間隔と回数
- 警報機能提供の放射温度計、警報温度の設定
- MODBUS RS485出力の場合、スレーブアドレス設定

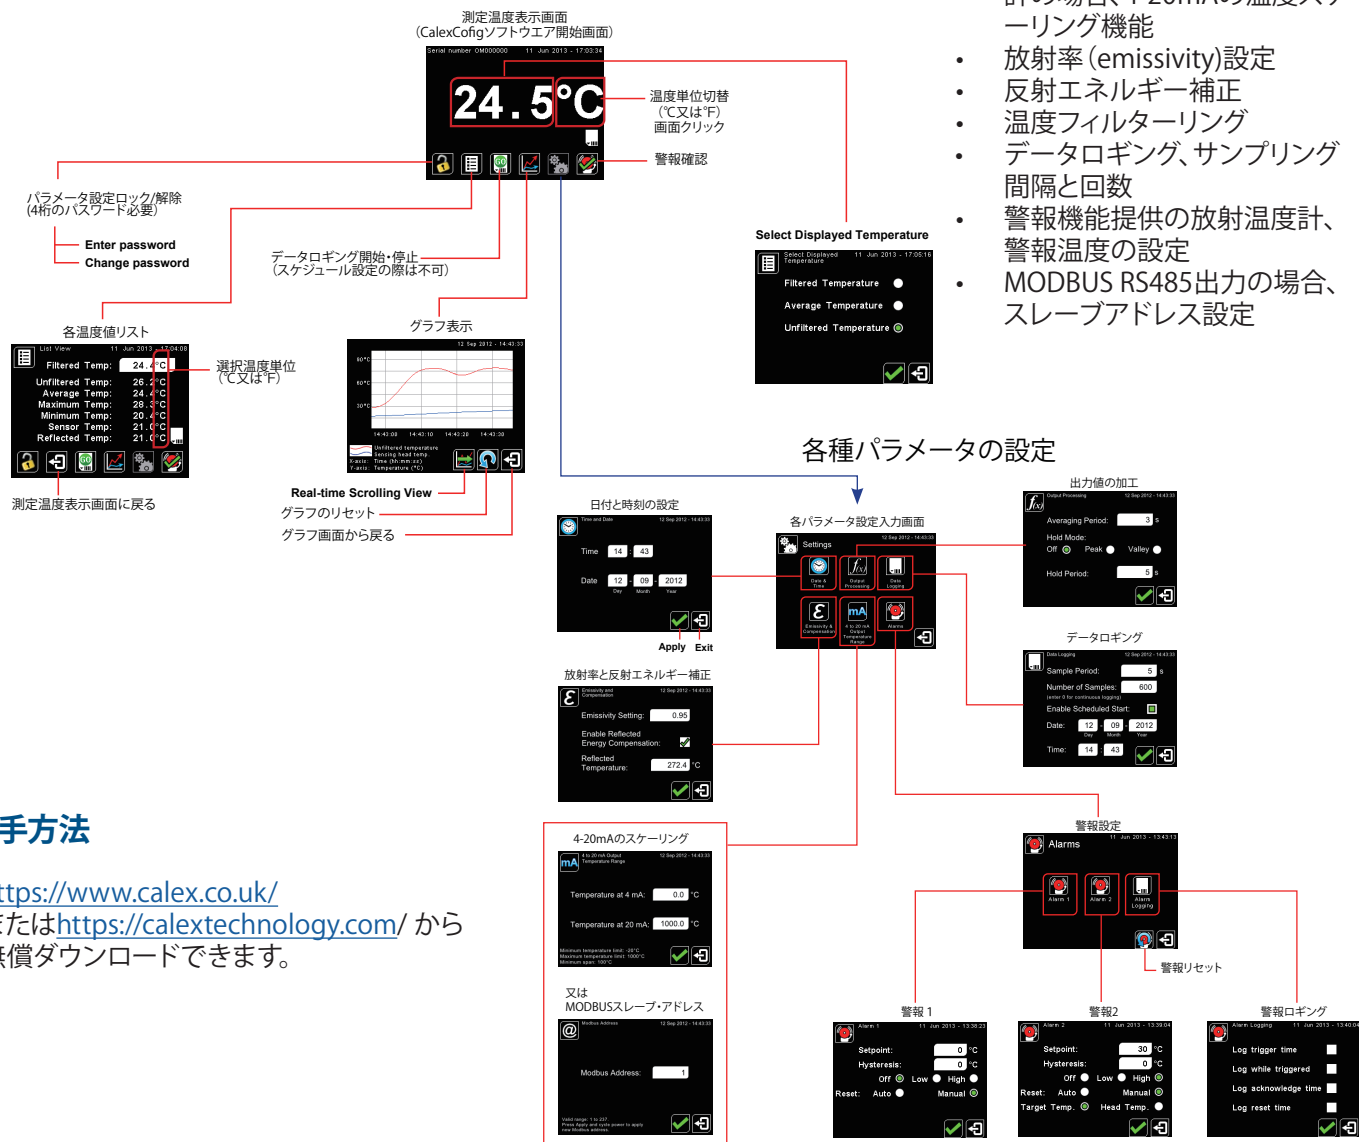

### 入手方法

<https://www.calex.co.uk/>  
または<https://calextechnology.com/> から  
無償ダウンロードできます。