


CALEX社放射温度計用ソフトウェア(無償)

CalexConfigソフトウェア、放射温度計用、無償簡単ソフトウェア

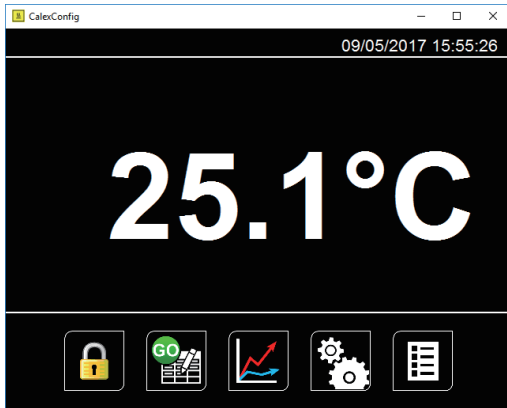

(記) CalexConfigソフトウェアの最新バージョンはホームページで確認く


- 測定温度の読み取り表示
- 放射温度計のコンフィギュレーション (設定)
- データのスクローリング、温度グラフ表示
- コンマ区切りのテキストファイル(csv)でのデータロギング(Excel変換対応)

適合形式(USBバージョン)
適合形式(RS485 modbusバージョン)
システム要件

PyroMiniUSB, PyroUSB, ExTempMini, ExTemp PyroMiniBus, PyroMini (-BB and -BRT) デスクトップPCまたはパネル PC Windows 7 または以降 (32 or 64 bit), 最低800x600 スクリーン解像度, タッチスクリーン, またはマウスとキーボード

* ExTemp/EXTempMini 本安防爆形放射温度計での使用時、ソフトウェアはセンサのコンフィギュレーション (設定) です。連続温度測定には4-20mA出力を使用ください。

PyroMini の場合のCalexConfigソフトウェア画面

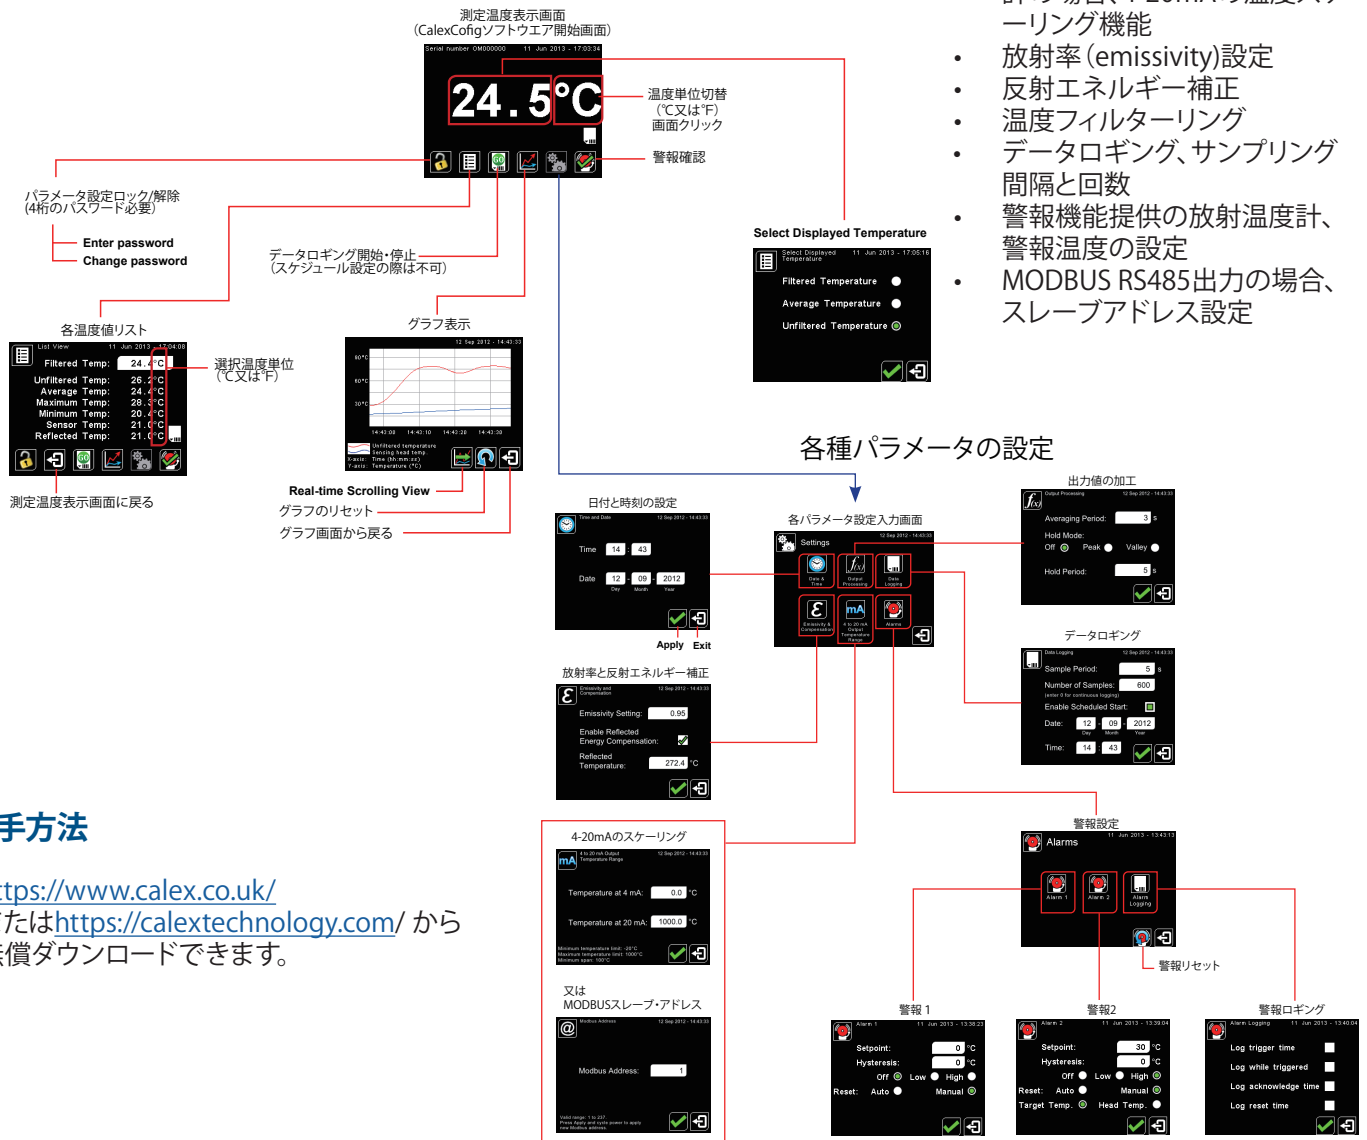

入手方法

<https://www.calex.co.uk/>
または<https://calextechnology.com/> から
無償ダウンロードできます。